



架橋グラフェンを用いた超高感度共振質量センサによる非標識生体分子検出

Toyohashi University of Technology
Integrated Biosensor & MEMS Group

高橋 一浩


IBMG
Integrated Biosensor and MEMS Group

HEIGHLIGHT



- 分子の選択的検出のため、キャビティ封止型の架橋グラフェンを作製し、ウェットプロセスにより分子の修飾を実現した。
- 抗体を修飾した架橋グラフェン上で抗原抗体反応を利用して抗原を非標識検出し、質量感度13.2 zg/Hzを達成した。
- オンチップ共振測定に向けて、ジュール熱によるグラフェン共振器の加振を行い、3桁程度の低消費電力化に成功した。

1. マーカーを利用した病気診断やウイルス検出

- 血液や尿などに含まれる生体分子や呼気ガス、皮膚ガスを測定すると、病気の診断、治療の効果の判定などに利用できる
- 空気中のウイルスを計測する環境計測型センサによって感染防止に貢献できる

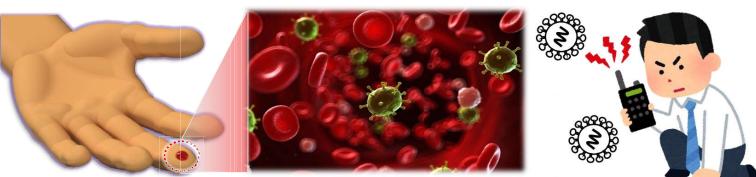


□ グラフェンを用いた非標識バイオセンサ

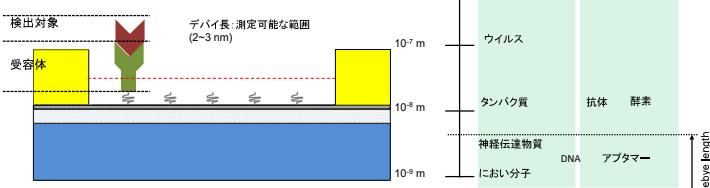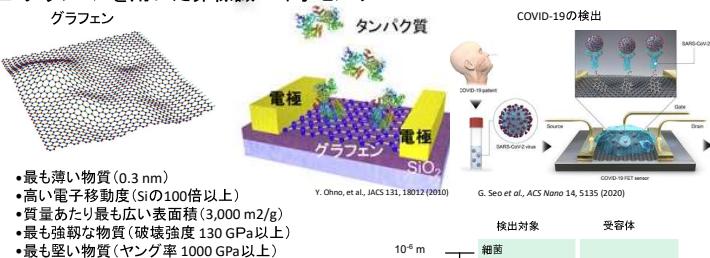

FET型センサではデバイス長の制約のため、タンパク質、ウイルスなどのサイズの大きい分子の検出が困難

2. グラフェンを用いた共振質量センサ

□ MEMS共振器センサ




$$f - \Delta f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m + \Delta m}}$$

□ 膜に微小質量Δmが付着すると、共振周波数がΔfシフトし、そのシフト量で質量を検出する原理である。

$$S_m = \lim_{\Delta m \rightarrow 0} \frac{-1}{f_0} \frac{\Delta f}{\Delta m / A} = \frac{1}{2\rho t}$$

□ グラフェンはシリコンより低密度、薄膜であることから共振器の振動膜として用いることで高い質量感度が期待できる。

ブリッジ構造では分子修飾が困難

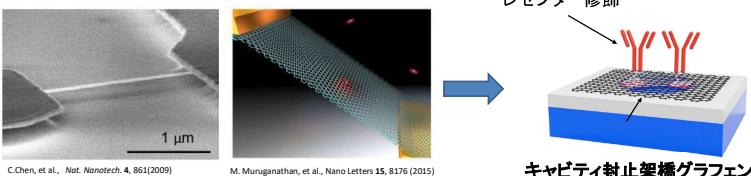


研究目的: グラフェン表面を化学的に機能化することにより選択的分子検出と質量計測の実現

	移動度	分子選択性	検出可能分子サイズ
GFET	△	○	1-2 nm (デバイス長)
ブリッジグラフェン	○	×	制約なし
キャビティ封止架橋グラフェン	○	○	制約なし

3. レーザー励起法による共振測定と質量計測


□ 共振周波数測定方法

強度変調を書いた励起レーザーによりグラフェンを加振し、プローブレーザーの反射光強度変化から周波数解釈

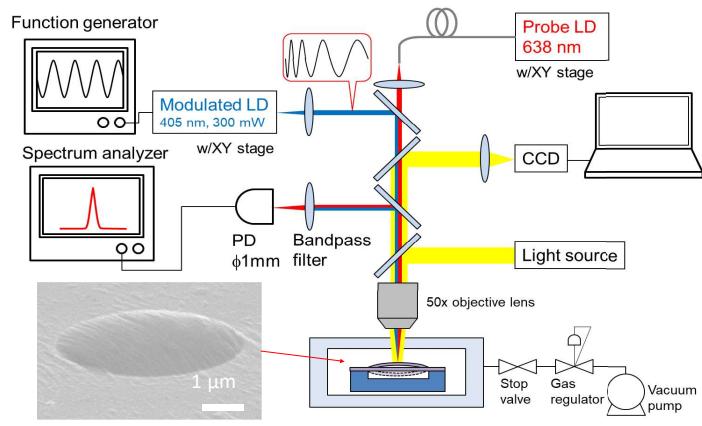

□ 質量測定

- 未処理の状態で共振測定
- 架橋剤修飾後、HSA抗体溶液(濃度100μg/mL)に浸漬
- 共振測定
- HSA抗原溶液(濃度1ng/mL)に60分浸漬後、DIW洗浄、乾燥後に共振測定



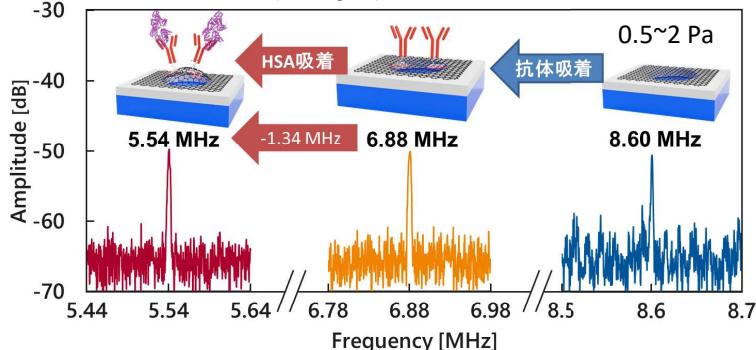


グラフェン単位面積の質量: $7.4 \times 10^{-16} \text{ g}/\mu\text{m}^2$
吸着質量 $\Delta m = 17.7 \text{ fg}$ 質量感度: $13.2 \text{ zg}/\text{Hz}$

シリコン共振センサの質量感度 0.5ag/Hz 従来技術より38倍優れた質量感度を達成

4. ジュール熱駆動によるグラフェンの共振周波数計測

□ レーザー励起とジュール熱駆動によるグラフェンの加振方法の比較を行った

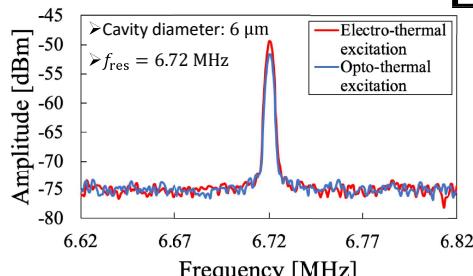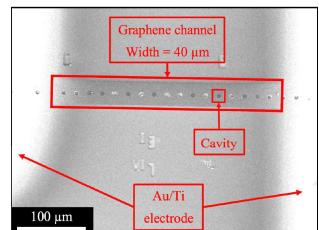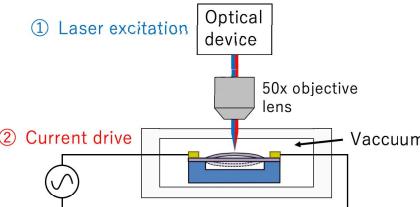

Power of laser excitation: 55.6 mW
Current driving power at Joule heating: 18.62 μW